0_2 キャリアーホルダー（車椅子用）
取扱説明書

1. 安全上の注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 耐荷重は 20kg です。車椅子が転倒するおそれがありますので、本品にそれ以上の無理な力がかからないようにしてください。
3) 各固定ノブ、取付用ノブがしっかり締まっているか、定期的に（週に一回以上）点検してください。
   ノブがゆるんだ状態で使用されますと、転倒や破損の原因となります。必ず定期的に点検を行い、ゆるみがある場合は増し締めをしてください。
4) 酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスであり、火を近づけると大変危険です。酸素ボンベ使用中は火気の取り扱いにご注意ください。
   (1) 酸素吸入中は、周囲２ｍ以内には火気を置かないでください。
   (2) 患者さん自身はもちろん、介助する方、家族の方なども酸素ボンベの周辺での喫煙や火気は厳禁です。

2. 製品概要と各部・付属品の名称

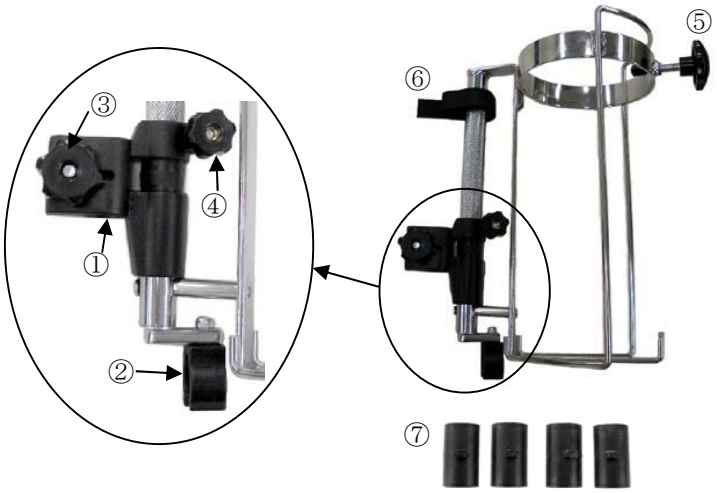

部品名	数量
①固定ホルダーⒶ	1
②固定ホルダーⒷ	1
③車椅子取付用ノブ	1
④ボンベホルダー固定ノブ	1
⑤酸素ボンベ固定ノブ	1
⑥マジックカフ	1
⑦割りピン(7/8 ｲﾝﾁ(22㎜)パイプ用) (3/4 ｲﾝﾁ(19㎜)パイプ用)	各1組

耐荷重　　：約 20kg
全長　　：320㎜
重量　　：約 1.2kg
搭載可能なボンベ直径：φ90㎜～110㎜

3. 使用方法とその注意事項

⚠ 注意

① 車椅子への取り付けは、平坦な場所で行ってください。
② 必ず車椅子のブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で取り付けてください。
③ 固定ホルダーⒶは１インチ(25㎜)パイプ用です。車椅子のパイプがそれより細い場合、固定ホルダーⒶに付属の割りピンを取り付けてください。
（次頁の【割りピンの取付方法(車椅子のパイプが細い場合)】参照。）

1) 車椅子取付用ノブをゆるめて固定ホルダーⒶから取り外します。
2) 固定ホルダーⒶ、Ⓑを車椅子のパイプにしっかりとはめこみます。

3) 取り外した車椅子取付用ノブを固定ホルダーⒶに取り付け、しっかりと締めます。
ボンベホルダー固定ノブをしっかりと締めます。

> ⚠ **注意**
> 各固定ノブ、取付用ノブは、車椅子の車輪に触れないよう車椅子の内側に取り付けてください。

4) マジックカフを車椅子のパイプにしっかりと巻きつけます。

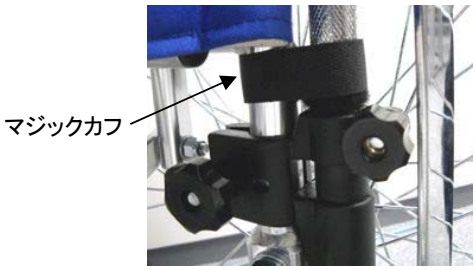

5) 酸素ボンベをボンベホルダーにセットし、酸素ボンベ固定ノブを締めて固定します。

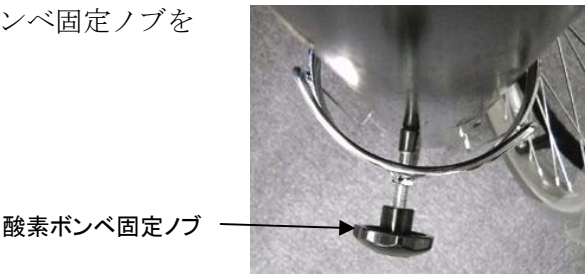

【割りピンの取付方法(車椅子のパイプが細い場合)】

1) 固定ホルダーⒶから車椅子取付用ノブを取り外します。
2) 割りピンを右図のように固定ホルダーⒶに挿入し、車椅子のパイプに取り付けます。(割りピンにより 19㎜、22㎜ のパイプに取り付けが可能となります。)

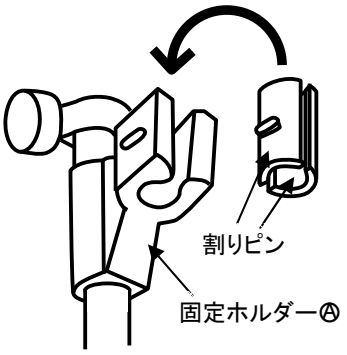

4. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

注文コード	品番	商品名
502-022-33	HP3041	O_2キャリアーホルダー(車椅子用)